

計測製品 SAMPLE 1

発行日：2006-09-20

Date

発行番号：YK33HS-A5G0214

Issue No.

## 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

形名 (Model ) : CA150  
製品名称 (Description ) : ハンディ キャル (Handy Cal)  
計器番号 (Serial No. ) :

上記製品は、当社の製造基準および横河マニュファクチャリング株式会社の作業標準にしたがって校正され、校正作業における検査または試験の結果は仕様を満たしています。

この校正に使用した測定器は横河マニュファクチャリング株式会社の計測器管理システムにより校正されています。横河マニュファクチャリング株式会社の計測器管理システムにおける一次標準の照合用標準器は、産業技術総合研究所をはじめとする国立研究所の標準、またはそれらの研究所によって認められている標準にトレーサビリティがとれています。その他特定分野においては、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的機関の標準、および計測器メーカを経由して、前述の公的校正機関の標準にトレーサビリティがとれています。

Yokogawa Meters & Instruments Corporation certifies that this instrument has undergone stringent calibration in accordance with Yokogawa Meters & Instruments Corporation product manufacturing standards / Yokogawa Manufacturing Corporation manufacturing and working procedures and the result of inspection or testing for calibration meets the product specifications.

Yokogawa Manufacturing Corporation also certifies that the measuring instruments which are used for the calibration are calibrated by Yokogawa Manufacturing Corporation Measuring Instruments Control System. Yokogawa Manufacturing Corporation primary standards which are used in the Measuring Instruments Control System are traceable to the standards of governmental laboratories such as the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, or are traceable to the standards of organizations which are approved by these governmental laboratories.

In special fields, Yokogawa Manufacturing Corporation primary standards are traceable to the standards of official organizations which are a member of the International Committee of Weights and Measures, or the previous mentioned governmental organizations through other instrument manufacturers.

横河マニュファクチャリング株式会社  
甲府工場 第3製造部 1Gr  
1Group Manufacturing Dept. 3 Kofu Factory  
Yokogawa Manufacturing Corporation

Y. Iguchi

本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。  
THIS CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT  
THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF YOKOGAWA METERS & INSTRUMENTS CORPORATION.

横河メータ&インストルメンツ株式会社  
Yokogawa Meters & Instruments Corporation

東京都立川市栄町6-1-3 〒190-8586  
6-1-3Sakaecho, Tachikawa-shi, Tokyo 190-8586 Japan

計測製品 SAMPLE 2


発行日: 2006-09-20  
Date  
発行番号: YK33HS-A5G0214  
Issue No.

# 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

形名 (Model ) : CA150  
製品名称 (Description ) : ハンディ キャル (Handy Cal)  
計器番号 (Serial No. ) :

横河マニュファクチャリング(株)の計測器管理システム  
Yokogawa Manufacturing Corporation Measuring Instruments Control System

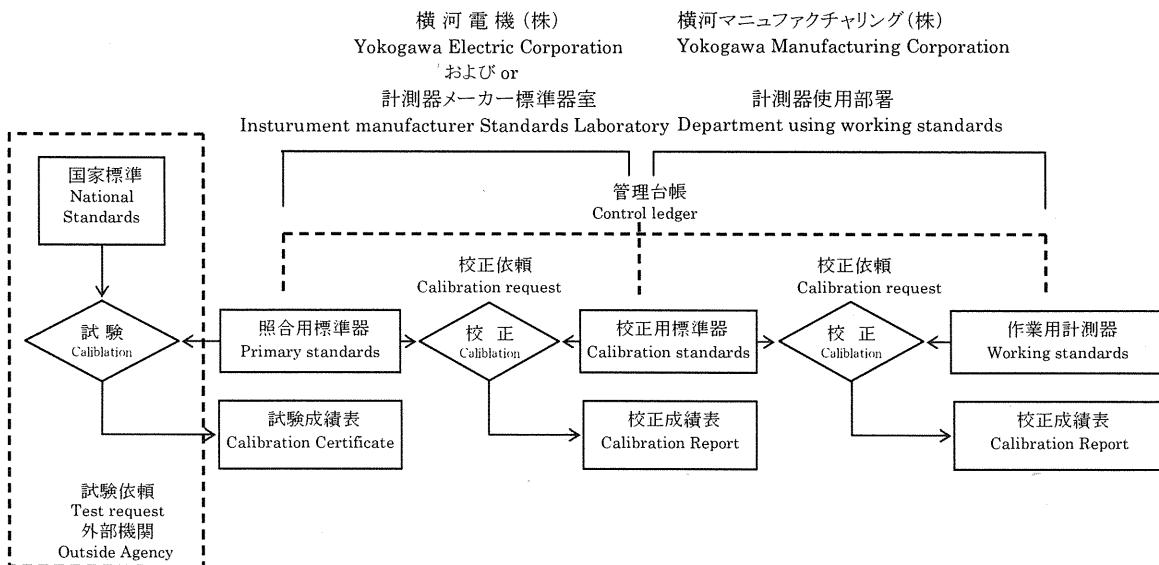

外部機関 : 日本における国家標準は下記の機関において、それぞれが担当する量ごとに維持されています。

産業技術総合研究所 (AIST), 日本電気計器検定所 (JEMIC)  
日本品質保証機構 (JQA) など

Outside agency : Official Agencies as shown below, establish the relevant National Standards in Japan.  
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)  
Japan Electric Meters Inspection Corporation (JEMIC)  
Japan Quality Assurance Organization (JQA) and others.

本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。  
THIS CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF YOKOGAWA METERS & INSTRUMENTS CORPORATION.

横河マニュファクチャリング株式会社  
Yokogawa Manufacturing Corporation

横河メータ&インスツルメンツ株式会社  
Yokogawa Meters & Instruments Corporation

東京都立川市栄町6-1-3 〒190-8586  
6-1-3Sakaecho, Tachikawa-shi, Tokyo 190-8586 Japan

計測製品 SAMPLE 3

発行日: 2006-09-20

Date

発行番号: YK33HS-A5G0214

Issue No.

## 校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

形名 (Model) : CA150  
製品名称 (Description) : ハンディ キャル (Handy Cal)  
計器番号 (Serial No.) :

### 照合用標準器一覧 Primary Standards List

形名 Model	名称 Description	試験成績書番号 Calibration Certificate Number	最新試験年月日 Last Calibrated Date
1. M/2781	標準抵抗器 Standard Resistor	第065084号	2006年06月29日
2. M/732A	直流標準電圧発生器 DC Voltage Standard	第065085号	2006年06月30日
3. M/750A	基準分圧器 Reference Divider	証明書番号050097	2006年04月14日
4. BB660	白金測温抵抗体 Platinum Resistance Temperature Detector	014-050965-100	2006年04月12日

本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。  
THIS CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT  
THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF YOKOGAWA METERS & INSTRUMENTS CORPORATION.

横河マニユファクチャリング株式会社  
Yokogawa Manufacturing Corporation

横河メータ&インスツルメンツ株式会社  
Yokogawa Meters & Instruments Corporation

東京都立川市栄町6-1-3 〒190-8586  
6-1-3Sakaecho, Tachikawa-shi, Tokyo 190-8586 Japan

計測製品 SAMPLE 4

発行日: 2006-09-20

Date

発行番号: YK33HS-A5G0214

Issue No.

## 校正証明書 CALIBRATION CERTIFICATE

形名 (Model) : CA150  
製品名称 (Description) : ハンディ キャル (Handy Cal)  
計器番号 (Serial No.) :

### 作業用計測器一覧 Working Standards List

形名 Model	名称 Description	計器番号 Serial No.
1. 3458A	デジタル マルチメータ Digital Multi Meter	2823A15777
2. TYPE-K	熱電対 Thermocouple	TC02
3. FP-5	0°C基準温度装置 Thermocouple Ice-Point Reference Unit	865213
4. 706011	シンセサイズド <sup>†</sup> ファンクション ジェネレータ Synthesized Function Generator	91F850504

本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。  
THIS CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT  
THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF YOKOGAWA METERS & INSTRUMENTS CORPORATION.

横河マニュファクチャリング株式会社  
Yokogawa Manufacturing Corporation

横河メータ&インスツルメンツ株式会社  
Yokogawa Meters & Instruments Corporation

東京都立川市栄町6-1-3 〒190-8586  
6-1-3Sakaecho, Tachikawa-shi, Tokyo 190-8586 Japan